

ブリスターシール材質変更に伴うご案内

謹啓 平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」につきまして、下記のとおり、ブリスターシールの材質変更を致しますのでご案内申し上げます。


今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

1. 変更内容

(1) ラベルの変更

- ① ダイヤマーク(◆)を削除致します。

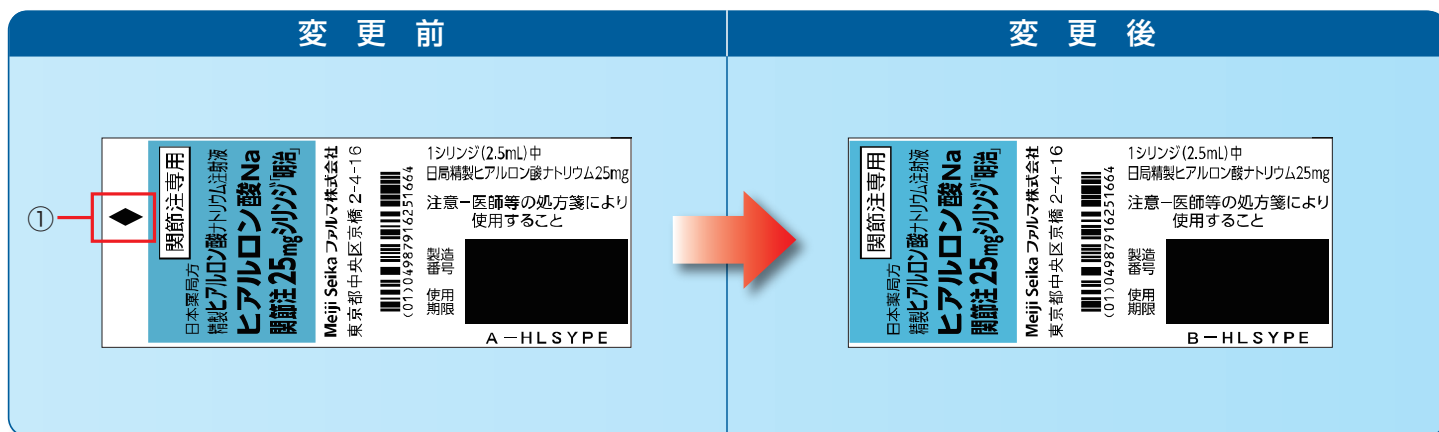


※画像はロックありです。ロックなしについても同様に変更致します。

(2) ブリスターシールの変更

- ① リサイクルPETへの変更に伴い、材質をPAからPETへ変更致します。

※PAはPolyAmide(ナイロン)のこと。


- ② 「PETボトルリサイクル推奨マーク」を追加致します。

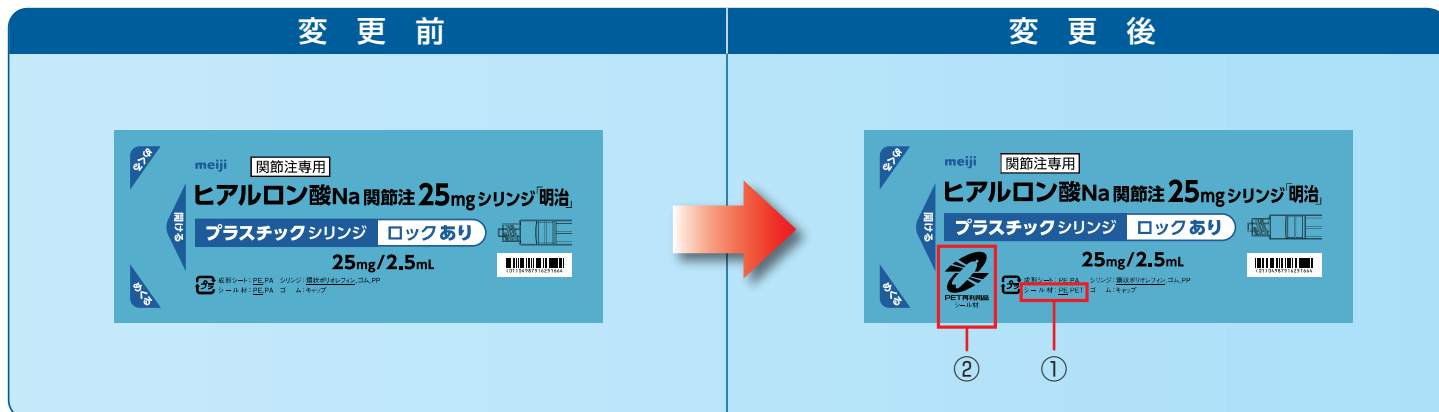

※画像はロックありです。ロックなしについても同様に変更致します。

(3) 個装箱の変更

①「PETボトルリサイクル推奨マーク」を追加致します。

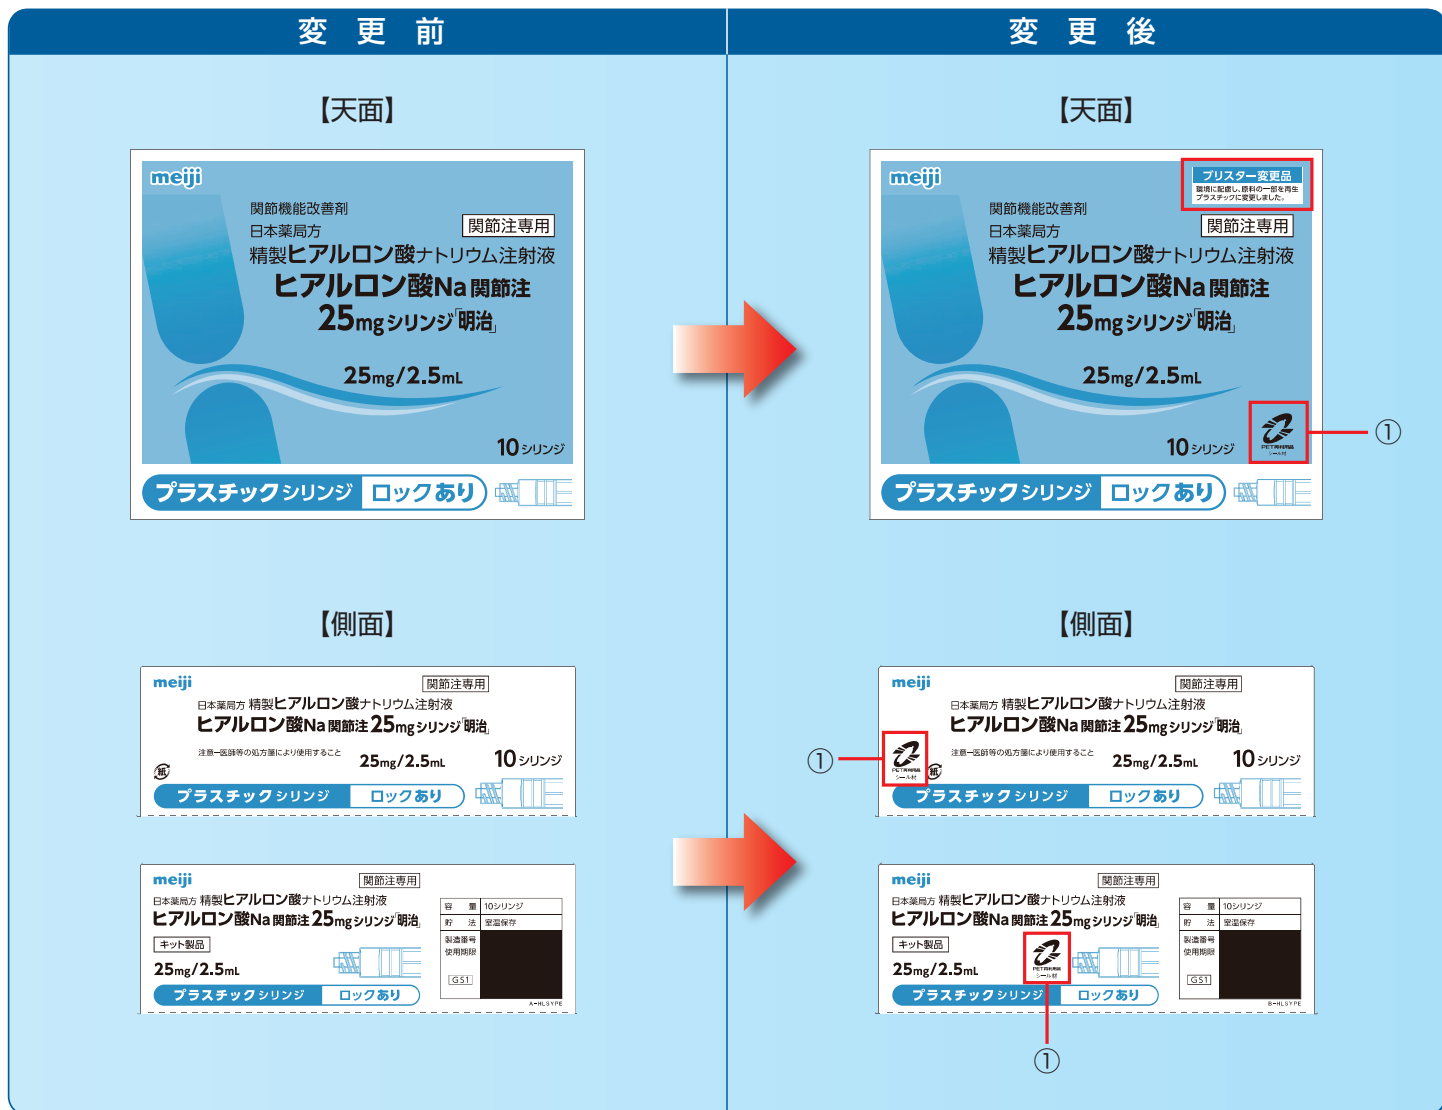

※画像はロックありです。ロックなしについても同様に変更致します。

2. 変更のお知らせ表示

一定期間、個装箱のみ「ブリストア変更品」と表示致します。

3. 変更品の製造番号及び出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ヒアルロン酸Na 関節注 25mg シリンジ 明治	10シリンジ (ロックあり)	916-00255-6	00067	2025年1月
	10シリンジ (ロックなし)	916-00256-3	00032	2024年12月

■貯法：室温保存 ■使用期限：シリンジ及び外箱に最終年月表示

※弊社の在庫状況により出荷時期が異なる場合がございますのでご了承願います。

販売元
Meファルマ株式会社
東京都中央区京橋2-4-16
https://www.me-pharma.co.jp/

製造販売元
Meiji Seika ファルマ株式会社
東京都中央区京橋2-4-16
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/

〈問い合わせ先〉
Meiji Seika ファルマ株式会社 ぐすり相談室
(Meファルマ株式会社 専用ダイヤル)
〒104-8002 東京都中央区京橋2-4-16
フリーダイヤル(0120)261-158
FAX(03)3272-2438

作成：2024.09